



Authorized Letter

Distributors/partners who sell our self-test antigen products must be authorized by Lepu .Ara Macao GmbH is the authorized agent of our company. The packaging used for the Lepu self-test antigen products sold on the market as its agent is the approved customized packaging.

The details of customized packaging as follows:

合格证/ Certificate of qualification	
产品名称 Product name	新型冠状病毒(SARS-CoV-2)抗原检测试剂盒 (胶体金免疫层析法) / SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Kit(Colloidal Gold Immunochromatography)
执行标准 Executive standard	新型冠状病毒(SARS-CoV-2)抗原检测试剂盒 (胶体金免疫层析法) 质量标准/SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test Kit(Colloidal Gold Immunochromatography) Quality standard
生产地址 Address	北京市昌平区科技园超前路37号7-1楼 /Building 7-1 No. 37, Chaoqian Road, Changping District, Beijing,102200,P.R.China.
检验员 Inspector	检验06
批号/Lot	21CG2719X
生产日期 Date of manufacture	24/03/2021
失效日期 Service life	24/09/2022

北京乐普诊断科技股份有限公司
Beijing Lepu Medical Technology Co., Ltd.

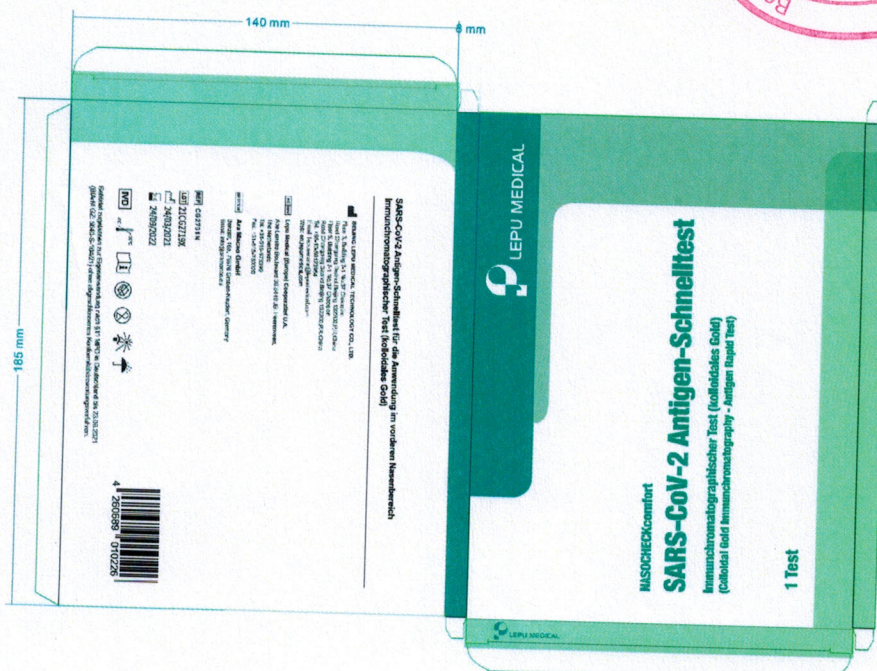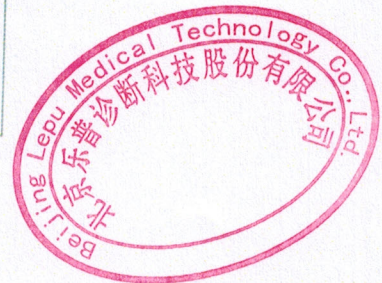

Gebrauchsanweisung

NASOCHIEKONFORT SARS-CoV-2-Antigen-Schnelltest

Ein Schnelltest zur Erkennung von SARS-CoV-2 (COVID-19) basierend auf der Antigen-Nachweis-Technologie. Dieser Test ist für die Erkennung von SARS-CoV-2-Antigenen im Nasensekret geeignet. Der Test ist für die Erkennung von SARS-CoV-2-Antigenen im Nasensekret geeignet. Der Test ist für die Erkennung von SARS-CoV-2-Antigenen im Nasensekret geeignet.

- NASOCHIEKONFORT ist ein SARS-CoV-2-Antigen-Test, der auf einem Antigen-Nachweis-Prinzip basiert.
- Dieser Test ermöglicht die Erkennung von SARS-CoV-2-Antigenen im Nasensekret. Der Test ist für die Erkennung von SARS-CoV-2-Antigenen im Nasensekret geeignet. Der Test ist für die Erkennung von SARS-CoV-2-Antigenen im Nasensekret geeignet.
- Der Test ist für die Erkennung von SARS-CoV-2-Antigenen im Nasensekret geeignet. Der Test ist für die Erkennung von SARS-CoV-2-Antigenen im Nasensekret geeignet. Der Test ist für die Erkennung von SARS-CoV-2-Antigenen im Nasensekret geeignet.

WICHTIGE HINWEISE

Im Falle eines positiven Testergebnisses werden Sie sich bitte unverzüglich an Ihren Hausarzt oder andere Fachstellen wenden. Ein positives Testergebnis ist ein Hinweis auf eine Infektion mit SARS-CoV-2. Ein negatives Testergebnis ist ein Hinweis auf keine Infektion mit SARS-CoV-2. Ein negatives Testergebnis ist ein Hinweis auf keine Infektion mit SARS-CoV-2. Ein negatives Testergebnis ist ein Hinweis auf keine Infektion mit SARS-CoV-2.

LAGEBEDINGUNGEN UND LAGERUNG

Haltbarkeit: 12 Monate (bei 4°C bis 30°C lagern)	bei 4°C bis 30°C lagern
Vor Sonnenlicht schützen	Trocken lagern
Unzugänglich für Kinder aufbewahren	

TESTPRINZIP

Die Testkarte enthält einen reaktiven Antigen-Nachweis-Test. Der Test ist für die Erkennung von SARS-CoV-2-Antigenen im Nasensekret geeignet. Der Test ist für die Erkennung von SARS-CoV-2-Antigenen im Nasensekret geeignet. Der Test ist für die Erkennung von SARS-CoV-2-Antigenen im Nasensekret geeignet. Der Test ist für die Erkennung von SARS-CoV-2-Antigenen im Nasensekret geeignet.

VERFAHRENSBESCHREIBUNG

1. Die Testkarte dieses Produkts besteht aus einem Antigen-Nachweis-Test. Der Test ist für die Erkennung von SARS-CoV-2-Antigenen im Nasensekret geeignet. Der Test ist für die Erkennung von SARS-CoV-2-Antigenen im Nasensekret geeignet. Der Test ist für die Erkennung von SARS-CoV-2-Antigenen im Nasensekret geeignet.
2. Die Testkarte dieses Produkts besteht aus einem Antigen-Nachweis-Test. Der Test ist für die Erkennung von SARS-CoV-2-Antigenen im Nasensekret geeignet. Der Test ist für die Erkennung von SARS-CoV-2-Antigenen im Nasensekret geeignet. Der Test ist für die Erkennung von SARS-CoV-2-Antigenen im Nasensekret geeignet.
3. Die Testkarte dieses Produkts besteht aus einem Antigen-Nachweis-Test. Der Test ist für die Erkennung von SARS-CoV-2-Antigenen im Nasensekret geeignet. Der Test ist für die Erkennung von SARS-CoV-2-Antigenen im Nasensekret geeignet. Der Test ist für die Erkennung von SARS-CoV-2-Antigenen im Nasensekret geeignet.

PRODUKTLEISTUNGSINDEX

1. Physikalische Eigenschaften: Die Testkarte sollte sauber und ohne Beschädigungen sein. Die Lösung sollte klar, homogen und ohne Verunreinigungen sein.
2. Genauigkeit: Die Genauigkeit der Testkarte sollte nicht weniger als 95% betragen.
3. Stabilität: Die Stabilität der Testkarte sollte nicht weniger als 10 Minuten betragen.

ANWENDUNG

1. Die Testkarte dieses Produkts besteht aus einem Antigen-Nachweis-Test. Der Test ist für die Erkennung von SARS-CoV-2-Antigenen im Nasensekret geeignet. Der Test ist für die Erkennung von SARS-CoV-2-Antigenen im Nasensekret geeignet. Der Test ist für die Erkennung von SARS-CoV-2-Antigenen im Nasensekret geeignet.
2. Die Testkarte dieses Produkts besteht aus einem Antigen-Nachweis-Test. Der Test ist für die Erkennung von SARS-CoV-2-Antigenen im Nasensekret geeignet. Der Test ist für die Erkennung von SARS-CoV-2-Antigenen im Nasensekret geeignet. Der Test ist für die Erkennung von SARS-CoV-2-Antigenen im Nasensekret geeignet.
3. Die Testkarte dieses Produkts besteht aus einem Antigen-Nachweis-Test. Der Test ist für die Erkennung von SARS-CoV-2-Antigenen im Nasensekret geeignet. Der Test ist für die Erkennung von SARS-CoV-2-Antigenen im Nasensekret geeignet. Der Test ist für die Erkennung von SARS-CoV-2-Antigenen im Nasensekret geeignet.

BEI DER ANWENDUNG DURCH MEDIZINISCHES PERSONAL

1. Bitte tragen Sie beim Testen Schutzkleidung, eine medizinische Maske, Handschuhe und Schutzbrille.
2. Entsorgen Sie gebrauchte Testkarten und andere Materialien in einem geschlossenen Behälter für medizinische Abfälle.
3. Der Test ist für die Erkennung von SARS-CoV-2-Antigenen im Nasensekret geeignet. Der Test ist für die Erkennung von SARS-CoV-2-Antigenen im Nasensekret geeignet. Der Test ist für die Erkennung von SARS-CoV-2-Antigenen im Nasensekret geeignet.

BEI DER ANWENDUNG DURCH MEDIZINISCHES PERSONAL

1. Bitte tragen Sie beim Testen Schutzkleidung, eine medizinische Maske, Handschuhe und Schutzbrille.
2. Entsorgen Sie gebrauchte Testkarten und andere Materialien in einem geschlossenen Behälter für medizinische Abfälle.
3. Der Test ist für die Erkennung von SARS-CoV-2-Antigenen im Nasensekret geeignet. Der Test ist für die Erkennung von SARS-CoV-2-Antigenen im Nasensekret geeignet. Der Test ist für die Erkennung von SARS-CoV-2-Antigenen im Nasensekret geeignet.


BEI DER ANWENDUNG DURCH MEDIZINISCHES PERSONAL

1. Bitte tragen Sie beim Testen Schutzkleidung, eine medizinische Maske, Handschuhe und Schutzbrille.
2. Entsorgen Sie gebrauchte Testkarten und andere Materialien in einem geschlossenen Behälter für medizinische Abfälle.
3. Der Test ist für die Erkennung von SARS-CoV-2-Antigenen im Nasensekret geeignet. Der Test ist für die Erkennung von SARS-CoV-2-Antigenen im Nasensekret geeignet. Der Test ist für die Erkennung von SARS-CoV-2-Antigenen im Nasensekret geeignet.

TESTPRINZIP



TESTKARTEN




TESTKARTEN

- Die Testkarte muss innerhalb 1 Stunde nach dem Öffnen des vorgelegten Beutels verwendet werden.
- Alle Teile der Testkarte müssen Raumtemperatur haben.
- Testkarte aufklappen
- Testkarte auf eine feste, glatte Unterlage legen
- Folie über dem Kabeistellen (K) entfernen

TESTKARTEN

- Tupfer zuerst 2-3 cm in die eine Nasenhöhle stecken
- ca. 2-3 cm
- Tupfer 3 Mal in Kreis drehen
- Dann Vorgang genauso in der zweiten Nasenhöhle wiederholen

TESTKARTEN



TESTKARTEN

- Die Testkarte muss innerhalb 1 Stunde nach dem Öffnen des vorgelegten Beutels verwendet werden.
- Alle Teile der Testkarte müssen Raumtemperatur haben.
- Testkarte aufklappen
- Testkarte auf eine feste, glatte Unterlage legen
- Folie über dem Kabeistellen (K) entfernen

TESTKARTEN

- Die Testkarte muss innerhalb 1 Stunde nach dem Öffnen des vorgelegten Beutels verwendet werden.
- Alle Teile der Testkarte müssen Raumtemperatur haben.
- Testkarte aufklappen
- Testkarte auf eine feste, glatte Unterlage legen
- Folie über dem Kabeistellen (K) entfernen

TESTKARTEN

- Die Testkarte muss innerhalb 1 Stunde nach dem Öffnen des vorgelegten Beutels verwendet werden.
- Alle Teile der Testkarte müssen Raumtemperatur haben.
- Testkarte aufklappen
- Testkarte auf eine feste, glatte Unterlage legen
- Folie über dem Kabeistellen (K) entfernen

TESTKARTEN

- Die Testkarte muss innerhalb 1 Stunde nach dem Öffnen des vorgelegten Beutels verwendet werden.
- Alle Teile der Testkarte müssen Raumtemperatur haben.
- Testkarte aufklappen
- Testkarte auf eine feste, glatte Unterlage legen
- Folie über dem Kabeistellen (K) entfernen

TESTKARTEN

- Die Testkarte muss innerhalb 1 Stunde nach dem Öffnen des vorgelegten Beutels verwendet werden.
- Alle Teile der Testkarte müssen Raumtemperatur haben.
- Testkarte aufklappen
- Testkarte auf eine feste, glatte Unterlage legen
- Folie über dem Kabeistellen (K) entfernen

TESTKARTEN

- Die Testkarte muss innerhalb 1 Stunde nach dem Öffnen des vorgelegten Beutels verwendet werden.
- Alle Teile der Testkarte müssen Raumtemperatur haben.
- Testkarte aufklappen
- Testkarte auf eine feste, glatte Unterlage legen
- Folie über dem Kabeistellen (K) entfernen

TESTKARTEN

- Die Testkarte muss innerhalb 1 Stunde nach dem Öffnen des vorgelegten Beutels verwendet werden.
- Alle Teile der Testkarte müssen Raumtemperatur haben.
- Testkarte aufklappen
- Testkarte auf eine feste, glatte Unterlage legen
- Folie über dem Kabeistellen (K) entfernen

TESTKARTEN

- Die Testkarte muss innerhalb 1 Stunde nach dem Öffnen des vorgelegten Beutels verwendet werden.
- Alle Teile der Testkarte müssen Raumtemperatur haben.
- Testkarte aufklappen
- Testkarte auf eine feste, glatte Unterlage legen
- Folie über dem Kabeistellen (K) entfernen


TESTKARTEN

- Die Testkarte muss innerhalb 1 Stunde nach dem Öffnen des vorgelegten Beutels verwendet werden.
- Alle Teile der Testkarte müssen Raumtemperatur haben.
- Testkarte aufklappen
- Testkarte auf eine feste, glatte Unterlage legen
- Folie über dem Kabeistellen (K) entfernen


TESTKARTEN

- Die Testkarte muss innerhalb 1 Stunde nach dem Öffnen des vorgelegten Beutels verwendet werden.
- Alle Teile der Testkarte müssen Raumtemperatur haben.
- Testkarte aufklappen
- Testkarte auf eine feste, glatte Unterlage legen
- Folie über dem Kabeistellen (K) entfernen

TESTKARTEN



TESTKARTEN




TESTKARTEN

- Die Testkarte muss innerhalb 1 Stunde nach dem Öffnen des vorgelegten Beutels verwendet werden.
- Alle Teile der Testkarte müssen Raumtemperatur haben.
- Testkarte aufklappen
- Testkarte auf eine feste, glatte Unterlage legen
- Folie über dem Kabeistellen (K) entfernen

TESTKARTEN

- Die Testkarte muss innerhalb 1 Stunde nach dem Öffnen des vorgelegten Beutels verwendet werden.
- Alle Teile der Testkarte müssen Raumtemperatur haben.
- Testkarte aufklappen
- Testkarte auf eine feste, glatte Unterlage legen
- Folie über dem Kabeistellen (K) entfernen

TESTKARTEN



TESTKARTEN

- Die Testkarte muss innerhalb 1 Stunde nach dem Öffnen des vorgelegten Beutels verwendet werden.
- Alle Teile der Testkarte müssen Raumtemperatur haben.
- Testkarte aufklappen
- Testkarte auf eine feste, glatte Unterlage legen
- Folie über dem Kabeistellen (K) entfernen

TESTKARTEN

- Die Testkarte muss innerhalb 1 Stunde nach dem Öffnen des vorgelegten Beutels verwendet werden.
- Alle Teile der Testkarte müssen Raumtemperatur haben.
- Testkarte aufklappen
- Testkarte auf eine feste, glatte Unterlage legen
- Folie über dem Kabeistellen (K) entfernen

TESTKARTEN

- Die Testkarte muss innerhalb 1 Stunde nach dem Öffnen des vorgelegten Beutels verwendet werden.
- Alle Teile der Testkarte müssen Raumtemperatur haben.
- Testkarte aufklappen
- Testkarte auf eine feste, glatte Unterlage legen
- Folie über dem Kabeistellen (K) entfernen

TESTKARTEN

- Die Testkarte muss innerhalb 1 Stunde nach dem Öffnen des vorgelegten Beutels verwendet werden.
- Alle Teile der Testkarte müssen Raumtemperatur haben.
- Testkarte aufklappen
- Testkarte auf eine feste, glatte Unterlage legen
- Folie über dem Kabeistellen (K) entfernen

TESTKARTEN

- Die Testkarte muss innerhalb 1 Stunde nach dem Öffnen des vorgelegten Beutels verwendet werden.
- Alle Teile der Testkarte müssen Raumtemperatur haben.
- Testkarte aufklappen
- Testkarte auf eine feste, glatte Unterlage legen
- Folie über dem Kabeistellen (K) entfernen

TESTKARTEN

- Die Testkarte muss innerhalb 1 Stunde nach dem Öffnen des vorgelegten Beutels verwendet werden.
- Alle Teile der Testkarte müssen Raumtemperatur haben.
- Testkarte aufklappen
- Testkarte auf eine feste, glatte Unterlage legen
- Folie über dem Kabeistellen (K) entfernen

TESTKARTEN

- Die Testkarte muss innerhalb 1 Stunde nach dem Öffnen des vorgelegten Beutels verwendet werden.
- Alle Teile der Testkarte müssen Raumtemperatur haben.
- Testkarte aufklappen
- Testkarte auf eine feste, glatte Unterlage legen
- Folie über dem Kabeistellen (K) entfernen

TESTKARTEN

- Die Testkarte muss innerhalb 1 Stunde nach dem Öffnen des vorgelegten Beutels verwendet werden.
- Alle Teile der Testkarte müssen Raumtemperatur haben.
- Testkarte aufklappen
- Testkarte auf eine feste, glatte Unterlage legen
- Folie über dem Kabeistellen (K) entfernen

TESTKARTEN

- Die Testkarte muss innerhalb 1 Stunde nach dem Öffnen des vorgelegten Beutels verwendet werden.
- Alle Teile der Testkarte müssen Raumtemperatur haben.
- Testkarte aufklappen
- Testkarte auf eine feste, glatte Unterlage legen
- Folie über dem Kabeistellen (K) entfernen

TESTKARTEN

- Die Testkarte muss innerhalb 1 Stunde nach dem Öffnen des vorgelegten Beutels verwendet werden.
- Alle Teile der Testkarte müssen Raumtemperatur haben.
- Testkarte aufklappen
- Testkarte auf eine feste, glatte Unterlage legen
- Folie über dem Kabeistellen (K) entfernen

内径尺寸

570.00 mm

450.00 mm

380.00 mm

NASOCHIEKONFORT

SARS-CoV-2 Antigen-Schnelltest

Immunochemiluminometrischer Test (Schulbildung: Gold)

(Colloidal Gold Immunoassay) - Antigen Rapid Test

400 x 1 Test

NASOCHIEKONFORT

SARS-CoV-2 Antigen-Schnelltest

Immunochemiluminometrischer Test (Schulbildung: Gold)

(Colloidal Gold Immunoassay) - Antigen Rapid Test

400 x 1 Test

NASOCHIEKONFORT

SARS-CoV-2 Antigen-Schnelltest

Immunochemiluminometrischer Test (Schulbildung: Gold)

(Colloidal Gold Immunoassay) - Antigen Rapid Test

400 x 1 Test

NASOCHIEKONFORT

SARS-CoV-2 Antigen-Schnelltest

Immunochemiluminometrischer Test (Schulbildung: Gold)

(Colloidal Gold Immunoassay) - Antigen Rapid Test

400 x 1 Test

BEIJING LEPU MEDICAL TECHNOLOGY CO.,LTD

Apr.19.2021